

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-1
Model:	30-WF6403
Operator:	JC,CM




Hour:	11:15
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle


Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	104
101	104,5
102	105
103	106
104	107,5
105	108
106	109,5
107	110
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115,5
113	116,5
114	117,5
115	118,5
116	119,5
117	120,5
118	121,5
119	122
120	123
130	133
140	144,5
150	153,5
160	163
170	173
180	183
190	193,5
200	203,5
300	303,5
400	404
500	504
600	604
700	705
800	804,5
900	904,5
1000	1005,5
2000	2007,5
3000	3009
4000	4011
5000	5013

Micrometer Calibration
Serie N° ZP366331

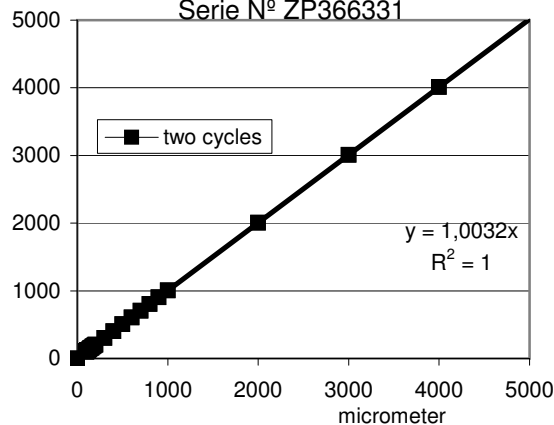

Gauge Block Data
Mitutoyo
Code N° 516-962-10
Type BM1-47D-0/PD
Serial N° 1103497
Grade: 0

Revised and approved by



2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103,5
101	104
102	105
103	106
104	107,5
105	108
106	109,5
107	110
108	111,5
109	112
110	114
111	114
112	115,5
113	116,5
114	117,5
115	118
116	119
117	120,5
118	121
119	122
120	123,5
130	133,5
140	144,5
150	153
160	162,5
170	173
180	183
190	195
200	203
300	303
400	404
500	504
600	604
700	704,5
800	804,5
900	904,5
1000	1005
2000	2007
3000	3010
4000	4011
5000	5013

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-2
Model:	30-WF6403
Operator:	AR,CM




Hour:	10:30
Temp. (°C):	22
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle


Gage Block	micrometer
0	0
100	104
100,5	105
101	105,5
102	106,5
103	107,5
104	108,5
105	109
106	110
107	111
108	112
109	113,5
110	115
111	116
112	116
113	118
114	118,5
115	119,5
116	120
117	121,5
118	122
119	124,5
120	124,5
130	134,5
140	145
150	154
160	163
170	174
180	184,5
190	194,5
200	204
300	304,5
400	404
500	503
600	604
700	704
800	805
900	904
1000	1004
2000	2005
3000	3004,5
4000	4006
5000	5005,5

Micrometer Calibration
Serie N° BP374236

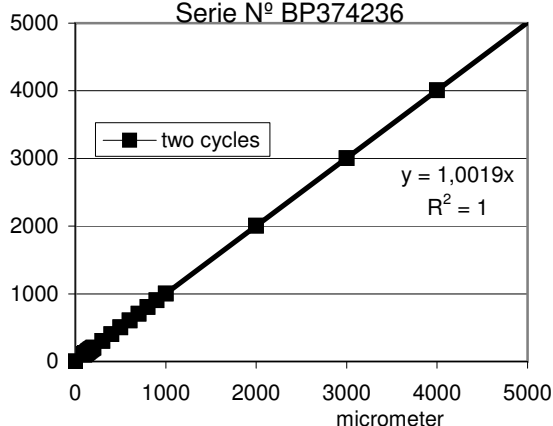

Gauge Block Data
Mitutoyo
Code N° 516-962-10
Type BM1-47D-0/PD
Serial N° 1103497
Grade: 0

Revised and approved by



2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103,5
100,5	105
101	106
102	105,5
103	107
104	108
105	108,5
106	110
107	111,5
108	112
109	115
110	114,5
111	115,5
112	117
113	116,5
114	118,5
115	119,5
116	120,5
117	122
118	122,5
119	123,5
120	124,5
130	134
140	144
150	153
160	163,5
170	174
180	184,5
190	194,5
200	204,5
300	305
400	404
500	504,5
600	604,5
700	704,5
800	805
900	905
1000	1003,5
2000	2005,5
3000	3004,5
4000	4004,5
5000	5005,5

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	05/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-3
Model:	30-WF6403
Operator:	AR,JC




Hour:	11:15
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm


1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	104
100,5	104
101	103
102	105
103	106
104	106
105	108
106	108
107	111
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115,5
113	116
114	117
115	118
116	119
117	120
118	120,5
119	123
120	123
130	133
140	143
150	154
160	162
170	172
180	183
190	193
200	203,5
300	302,5
400	404
500	503
600	603
700	704,5
800	803
900	903,5
1000	1003,5
2000	2005
3000	3005
4000	4005
5000	5005

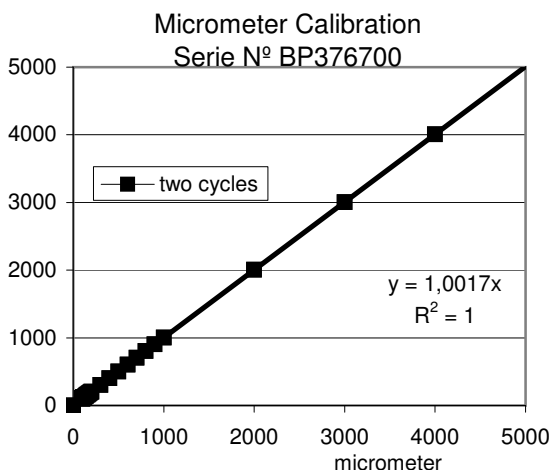

Gauge Block Data
Mitutoyo
Code N° 516-962-10
Type BM1-47D-0/PD
Serial N° 1103497
Grade: 0

Revised and approved by



2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	102,5
100,5	104
101	104
102	104
103	105
104	107
105	108
106	109
107	110
108	111
109	112
110	114
111	114
112	115,5
113	116,5
114	117
115	118,5
116	119
117	120
118	122
119	122
120	123,5
130	133
140	144
150	154
160	163
170	173
180	183,5
190	193
200	204
300	303,5
400	403,5
500	503
600	604
700	704
800	804
900	904
1000	1003,5
2000	2004
3000	3004,5
4000	4005
5000	5005,5

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-4
Model:	30-WF6403
Operator:	JC,CM




Hour:	10:55
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle


Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	104
102	105
103	105,5
104	107
105	108
106	109
107	110
108	111
109	113
110	115
111	113,5
112	115
113	116,5
114	117
115	117,5
116	118,5
117	120
118	121
119	122
120	122,5
130	132,5
140	142
150	152,5
160	164
170	173,5
180	183
190	193
200	202,5
300	303
400	403
500	503,5
600	603,5
700	704
800	803,5
900	903,5
1000	1004
2000	2005
3000	3006
4000	4007
5000	5008

Micrometer Calibration
Serie N° BP374700

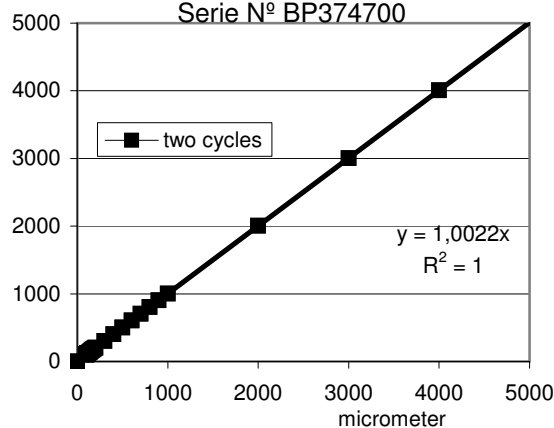

Gauge Block Data
Mitutoyo
Code N° 516-962-10
Type BM1-47D-0/PD
Serial N° 1103497
Grade: 0

Revised and approved by



2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	104
101	104
102	104,5
103	106
104	107,5
105	107,5
106	109
107	110
108	110
109	112
110	114,5
111	114
112	115
113	116
114	117
115	117,5
116	119
117	120
118	121
119	121,5
120	122,5
130	132,5
140	142,5
150	152,5
160	163,5
170	173
180	183
190	193
200	203
300	303
400	403
500	503,5
600	603,5
700	704
800	804
900	903,5
1000	1003,5
2000	2005,5
3000	3006
4000	4007
5000	5008

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	05/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-5
Model:	30-WF6403
Operator:	AR,CM




Hour:	10:15
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle


Gage Block	micrometer
0	0
100	104
100,5	104
101	104
102	104
103	105
104	106,5
105	107
106	108,5
107	109,5
108	110,5
109	111
110	113
111	113
112	114,5
113	115
114	117
115	117,5
116	118
117	120
118	121
119	121,5
120	123
130	132,5
140	142,5
150	153
160	162,5
170	172,5
180	182
190	193
200	203
300	302
400	402
500	503
600	602
700	705
800	804
900	903,5
1000	1002,5
2000	2004
3000	3004,5
4000	4004
5000	5003

Micrometer Calibration
Serie N° BP376705

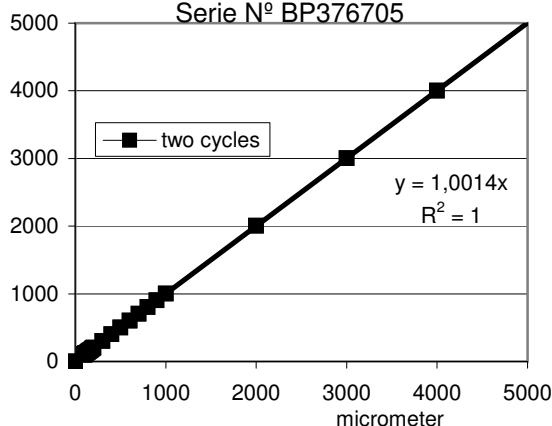

Gauge Block Data
Mitutoyo
Code N° 516-962-10
Type BM1-47D-0/PD
Serial N° 1103497
Grade: 0

Revised and approved by



2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	104
102	104
103	105
104	106
105	108
106	108,5
107	109
108	111
109	111
110	113
111	114
112	115
113	115
114	116
115	117,5
116	118
117	119
118	120
119	121,5
120	122
130	133
140	142,5
150	152,5
160	162,5
170	172
180	181,5
190	192
200	202
300	302,5
400	402,5
500	502
600	603,5
700	705
800	803,5
900	903
1000	1004
2000	2005
3000	3004,5
4000	4004
5000	5004

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	02/08/2012
Micrometer:	LCCF-C-6
Model:	3058S-19
Operator:	AR,CM




Hour:	10:55
Temp. (°C):	22
Range:	0,0-50,0mm

micrometer apreciation 1/100 mm

1st cycle


Gage Block	micrometer
0	0
100	102
100,5	102,5
101	104
102	105
103	106
104	107
105	108
106	109
107	110
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115
113	116
114	117
115	118
116	119
117	120
118	121
119	122
120	123
130	133
140	143
150	153
160	163
170	173
180	183
190	193
200	203
300	303
400	404
500	504
600	603
700	703
800	803
900	903
1000	1003
2000	2004
3000	3005
4000	4005
5000	5005,5

Micrometer Calibration
 Serie N° BP376685

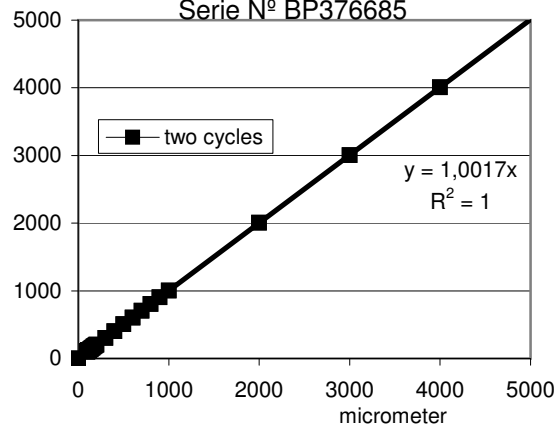

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by



2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	102,5
101	104
102	105
103	106
104	107
105	108
106	109
107	110
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115
113	116
114	117
115	118
116	119
117	120
118	121
119	122
120	123
130	133
140	143
150	153
160	163
170	173
180	183
190	193
200	203
300	304
400	404
500	504
600	604
700	704
800	803,5
900	904
1000	1003
2000	2004
3000	3005
4000	4005
5000	5005,5



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	02/08/2012
Micrometer:	LCCF-C-7
Model:	3058S-19
Operator:	AR,CM




Hour:	10:40
Temp. (°C):	22
Range:	0,0-50,0mm

Resolution: 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	104
100,5	104
101	104
102	106
103	107
104	108
105	109
106	110
107	111
108	112
109	113
110	114
111	115
112	116
113	117
114	118
115	119
116	120
117	121
118	122
119	122,5
120	124
130	134
140	144,5
150	155,5
160	164
170	174
180	183,5
190	193,5
200	204
300	304
400	404
500	504
600	604
700	704
800	804
900	904
1000	1004
2000	2004,5
3000	3005
4000	4005
5000	5005

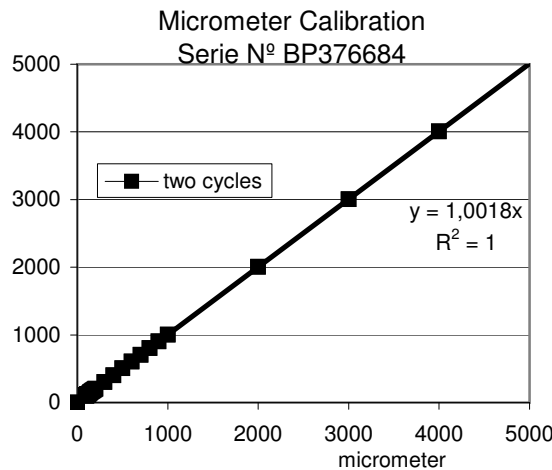

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	104
100,5	104
101	105
102	106
103	107
104	108
105	109
106	110
107	111
108	112
109	113
110	114
111	115
112	116
113	117
114	118
115	119
116	120
117	121
118	122
119	122,5
120	123,5
130	134
140	145
150	154
160	164
170	174
180	183,5
190	193,5
200	204
300	304
400	404
500	504
600	604
700	704
800	804
900	904
1000	1004
2000	2004,5
3000	3005
4000	4005
5000	5005



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-8
Model:	30-WF6403
Operator:	JC,CM




Hour:	11:25
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

Resolution 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103,5
100,5	104
101	103,5
102	104,5
103	106
104	106,5
105	107
106	109
107	110
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115
113	116
114	117
115	117,5
116	118,5
117	119,5
118	120,5
119	121,5
120	122
130	132,5
140	143
150	153
160	162,5
170	173
180	183
190	193
200	203
300	302
400	403
500	503,5
600	603
700	703,5
800	803
900	903,5
1000	1003,5
2000	2003
3000	3003
4000	4002,5
5000	5003,5

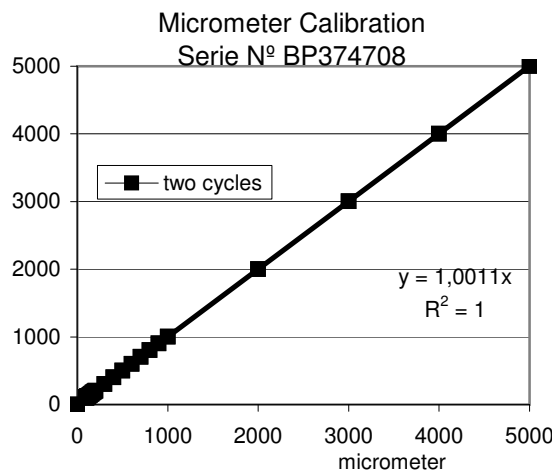

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	103,5
102	105
103	106
104	107
105	107
106	109
107	110
108	112
109	112
110	112,5
111	114
112	115
113	116
114	117
115	117,5
116	118,5
117	119,5
118	121,5
119	122
120	122,5
130	132
140	142,5
150	153
160	163
170	173
180	184,5
190	193,5
200	202,5
300	302,5
400	403
500	503
600	603
700	703
800	803
900	903
1000	1003
2000	2002
3000	3002
4000	4002
5000	5002



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	02/08/2012
Micrometer:	LCCF-C-9
Model:	3058S-19
Operator:	AR,CM




Hour:	0:00
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	104
102	105
103	106
104	107
105	108
106	109
107	110
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115
113	116
114	117
115	118
116	119
117	120
118	121
119	122,5
120	123,5
130	133
140	142,5
150	153
160	163
170	173
180	183
190	193
200	203
300	303
400	403,5
500	503,5
600	603,5
700	703,5
800	803
900	904
1000	1004
2000	2004
3000	3004,5
4000	4005
5000	5005

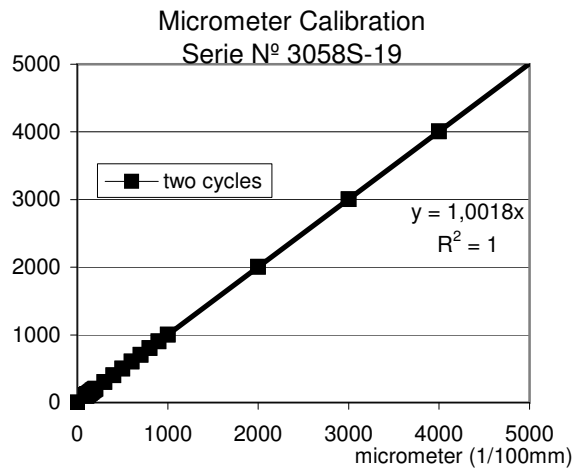

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	104
102	105
103	106
104	107
105	108
106	109
107	110
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115
113	116
114	117
115	118
116	119
117	120
118	121
119	122,5
120	123,5
130	133
140	143
150	153
160	163
170	173
180	183,5
190	193,5
200	203
300	303
400	403,5
500	503,5
600	604
700	704
800	803,5
900	903,5
1000	1004
2000	2004,5
3000	3005
4000	4006
5000	5006




Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-10
Model:	30-WF6403
Operator:	AR,CM

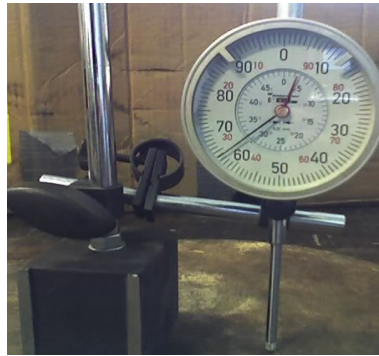


Hour:	10:00
Temp. (°C):	22
Range:	0,0-50,0mm

micrometer apreciation 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103,5
101	105
102	105,5
103	106
104	108
105	108
106	109
107	110
108	112
109	112,5
110	113,5
111	115
112	116
113	117
114	118
115	119
116	120
117	121
118	121
119	123
120	124
130	135
140	144,5
150	153,5
160	163,5
170	174
180	183
190	193
200	205
300	304
400	403,5
500	503,5
600	604,5
700	704,5
800	803
900	903,5
1000	1003
2000	2004
3000	3001,5
4000	4002,5
5000	5004

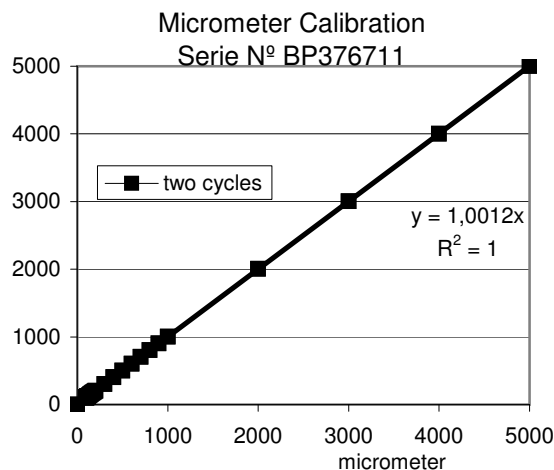

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	104
101	105
102	105,5
103	107
104	108,5
105	108,5
106	110
107	111
108	111,5
109	113
110	114
111	114,5
112	115
113	117,5
114	117
115	118
116	120
117	120,5
118	122
119	123
120	124
130	133,5
140	145
150	153,5
160	163,5
170	174
180	184
190	193,5
200	204,5
300	303,5
400	404,5
500	503,5
600	603
700	703
800	803
900	902,5
1000	1003
2000	2003,5
3000	3003,5
4000	4003
5000	5002



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	05/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-11
Model:	30-WF6403
Operator:	AR,JC




Hour:	11:00
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	101
100,5	101
101	103
102	102,5
103	104
104	105
105	106
106	107
107	109
108	110
109	110
110	113,5
111	114,5
112	115
113	118
114	118
115	118,5
116	120
117	120
118	122
119	122,5
120	124
130	132,5
140	144
150	154,5
160	164
170	173
180	184
190	193,5
200	204
300	304
400	405
500	504
600	605
700	704,5
800	805
900	905
1000	1005
2000	2006
3000	3006
4000	4008
5000	5012

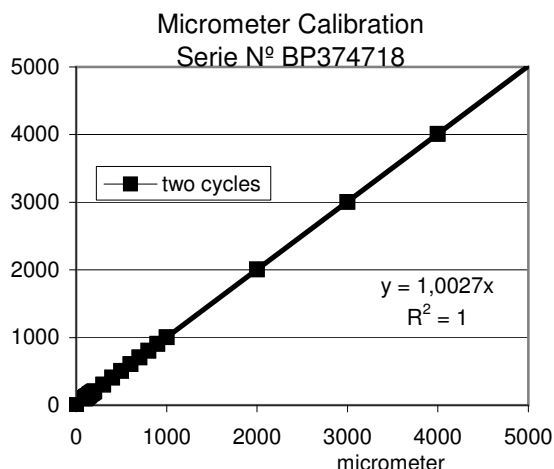

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	101
100,5	101,5
101	102
102	103
103	104
104	105
105	107
106	108
107	109
108	110
109	111
110	114
111	115
112	115,5
113	117,5
114	118
115	119
116	120
117	121
118	122
119	122,5
120	124
130	135
140	143
150	155
160	164
170	173,5
180	184
190	193,5
200	204
300	304
400	405
500	504
600	605
700	705
800	805
900	906
1000	1005
2000	2007
3000	3006
4000	4009
5000	5011



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	02/08/2012
Micrometer:	LCCF-C-12
Model:	3058S-19
Operator:	CM,AR




Hour:	11:30
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	101
100,5	102
101	102,5
102	104
103	105
104	105,5
105	107
106	108
107	109
108	110
109	111
110	112
111	113
112	114
113	114
114	115
115	117
116	118
117	119
118	120,5
119	121
120	122,5
130	132
140	143
150	153
160	162
170	172
180	182
190	192
200	203
300	302,5
400	402,5
500	504
600	604
700	704
800	804,5
900	905
1000	1005
2000	2008,5
3000	3011,5
4000	4015
5000	5018

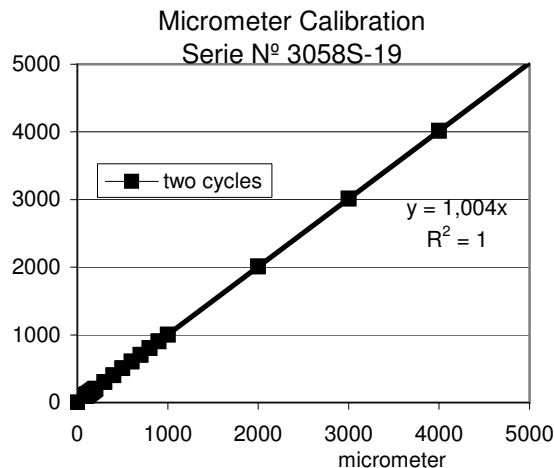

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	101
100,5	102
101	103
102	103,5
103	105
104	105,5
105	107
106	108
107	109
108	110
109	111
110	112
111	113
112	114
113	115
114	115,5
115	117
116	118,5
117	119
118	120
119	122
120	122,5
130	133
140	142,5
150	152
160	162
170	172,5
180	182,5
190	192
200	203
300	302
400	403
500	504
600	604
700	704,5
800	804,5
900	904,5
1000	1005
2000	2008,5
3000	3012
4000	4015
5000	5017,5



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-13
Model:	
Operator:	AR,CM




Hour:	12:45
Temp. (°C):	22
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	103,5
102	104,5
103	106,5
104	106,5
105	107,5
106	108,5
107	109,5
108	110,5
109	111,5
110	112,5
111	114
112	114,5
113	116
114	117
115	118
116	119
117	120
118	121
119	122
120	123
130	132,5
140	143
150	152,5
160	162,5
170	172,5
180	182,5
190	193
200	203
300	303
400	403
500	504
600	604,5
700	704
800	804,5
900	904,5
1000	1005
2000	2007
3000	3007
4000	4008,5

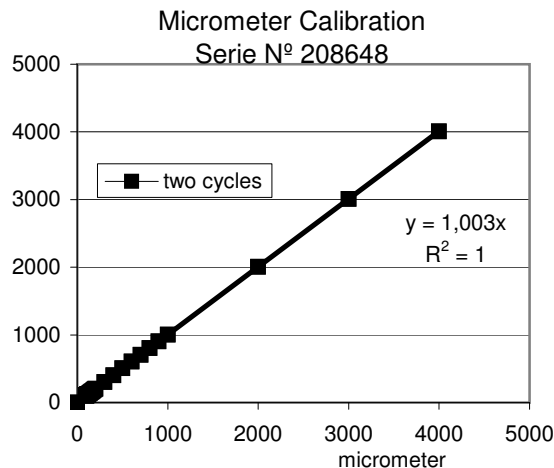

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	102,5
100,5	103
101	103,5
102	104,5
103	105,5
104	106,5
105	107,5
106	108,5
107	109,5
108	110,5
109	111,5
110	113
111	113,5
112	114,5
113	116
114	117
115	118
116	119,5
117	120
118	121
119	121,5
120	122,5
130	132,5
140	142,5
150	152,5
160	162
170	172,5
180	182,5
190	193
200	203
300	303
400	403
500	504
600	604,5
700	704
800	804,5
900	904,5
1000	1005
2000	2006,5
3000	3007
4000	4008,5
5000	0

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-14
Model:	
Operator:	AR,JC




Hour:	11:35
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

Resolution: 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	102
100,5	102
101	102,5
102	103,5
103	104,5
104	105,5
105	106,5
106	107
107	108,5
108	109,5
109	110
110	111,5
111	112,5
112	113
113	114
114	115
115	116,5
116	117,5
117	118,5
118	119,5
119	120
120	121
130	131
140	141,5
150	151
160	161,5
170	171
180	180,5
190	191
200	201
300	301,5
400	401,5
500	501,5
600	602,5
700	703,5
800	802,5
900	902,5
1000	1002
2000	2002,5
3000	3002,5
4000	4002,5
5000	5002,5

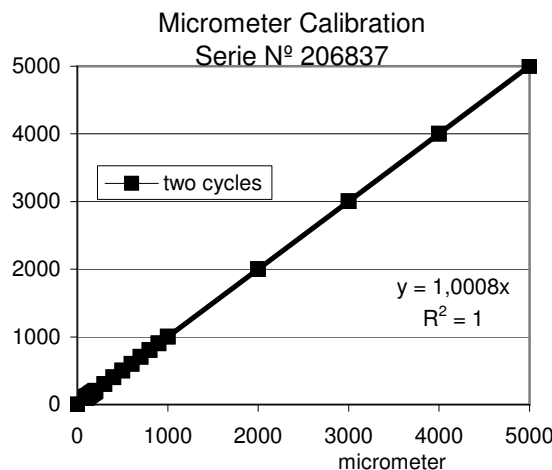

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	102
100,5	102
101	102,5
102	103,5
103	104,5
104	105,5
105	106,5
106	107,5
107	108,5
108	109,5
109	110,5
110	111,5
111	112,5
112	113,5
113	114
114	115
115	116,5
116	117,5
117	118,5
118	119,5
119	120
120	121,5
130	131
140	141
150	151
160	161
170	171
180	181
190	191
200	201,5
300	301
400	402
500	502,5
600	602
700	703
800	802,5
900	902,5
1000	1002,5
2000	2002,5
3000	3002
4000	4002
5000	5001,5



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-18
Model:	
Operator:	AR,CM




Hour:	12:30
Temp. (°C):	22
Range:	0,0-50,0mm

Resolution 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	103
102	104,5
103	106
104	108
105	108
106	110
107	110
108	111
109	112
110	113
111	114
112	115
113	116
114	116
115	118
116	119
117	120
118	121
119	122
120	123,5
130	133
140	143,5
150	153,3
160	163
170	173,5
180	183,5
190	193,5
200	204
300	304
400	404
500	504,5
600	604
700	704
800	803
900	904
1000	1004
2000	2005
3000	3005,5
4000	4006
5000	

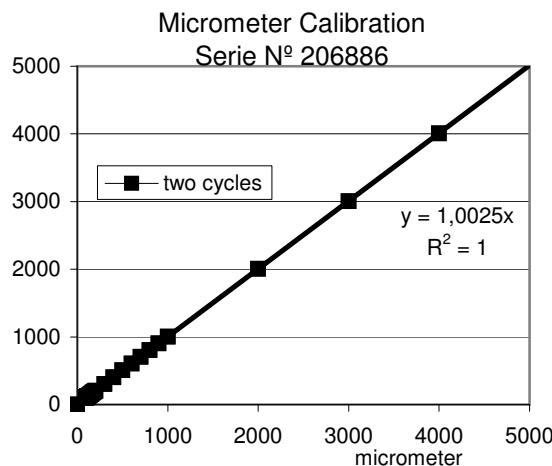

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103
101	103
102	104,5
103	105,5
104	107
105	108
106	111
107	110
108	111
109	113
110	114
111	115
112	116
113	117
114	117,5
115	118
116	118,5
117	120,5
118	121
119	122
120	123
130	133,5
140	143,5
150	154
160	163
170	173
180	183,5
190	194
200	203,5
300	304
400	404
500	505
600	604
700	704
800	803,5
900	904
1000	1003,5
2000	2004,5
3000	3005,5
4000	4006
5000	



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-19
Model:	
Operator:	AR,CM




Hour:	12:15
Temp. (°C):	22
Range:	0,0-50,0mm

Resolution: 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103,5
101	104
102	105
103	106
104	107
105	108
106	108,5
107	109,5
108	110,5
109	111,5
110	112,5
111	114
112	115
113	115,5
114	116,5
115	117
116	119
117	119,5
118	120,5
119	121,5
120	122
130	132
140	142
150	152,5
160	163
170	172,5
180	183
190	192,5
200	203
300	304
400	404
500	504
600	604
700	703,5
800	803,5
900	904
1000	1003
2000	2005
3000	3006
4000	4006
5000	5003

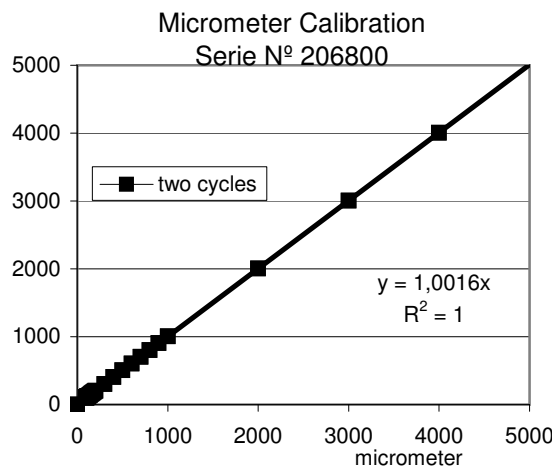

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	103
100,5	103,5
101	104
102	105
103	106
104	106,5
105	107,5
106	108,5
107	110
108	110,5
109	112
110	112,5
111	113,5
112	114,5
113	115,5
114	117
115	119
116	118,5
117	119,5
118	120,5
119	121,5
120	122,5
130	132
140	142
150	152,5
160	162,5
170	172
180	182,5
190	192,5
200	203
300	304
400	404
500	504
600	604
700	703,5
800	803,5
900	903,5
1000	1003,5
2000	2004
3000	3005
4000	4006
5000	5003



Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones
 Instituto de Estructuras y Transporte
 Tel.: 2711 0524 - 2711 2643
 Fax: 2711 2886
 Facultad de Ingeniería- Universidad de la República



INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
 Prof. JULIO RICALDONI

Micrometer Calibration Data Sheet

Date:	06/06/2012
Micrometer:	LCCF-C-20
Model:	
Operator:	AR,JC




Hour:	11:55
Temp. (°C):	21
Range:	0,0-50,0mm

micrometer appreciation 1/100 mm

1st cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	102
100,5	102
101	102,5
102	103,5
103	105
104	105
105	105,5
106	107
107	108
108	109,5
109	110
110	111,5
111	112
112	113
113	114,5
114	115
115	116
116	117
117	119
118	119,5
119	121
120	123
130	132
140	141,5
150	150,5
160	161,5
170	171
180	181,5
190	191,5
200	201,5
300	302
400	402,5
500	501,5
600	601
700	702
800	802
900	902
1000	1002
2000	2004
3000	3004,5
4000	4005
5000	5006,5

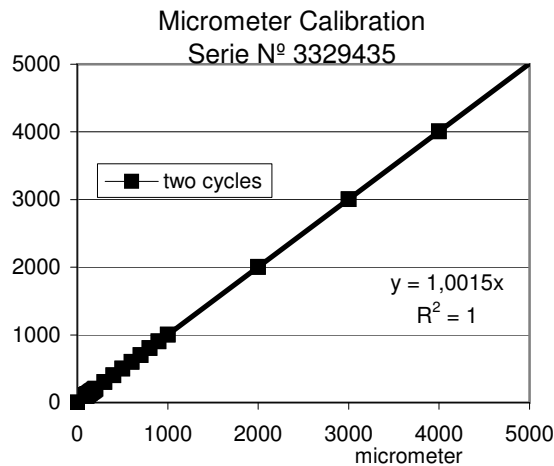

Gauge Block Data
 Mitutoyo
 Code N° 516-962-10
 Type BM1-47D-0/PD
 Serial N° 1103497
 Grade: 0

Revised and approved by

2nd cycle

Gage Block	micrometer
0	0
100	102
100,5	102
101	102,5
102	104
103	104,5
104	105,5
105	106,5
106	107
107	108
108	110
109	110,5
110	111,5
111	112,5
112	113,5
113	114,5
114	115,5
115	116,5
116	117,5
117	119
118	119,5
119	120,5
120	122
130	132
140	141,5
150	151
160	161,5
170	171
180	181,5
190	192
200	201,5
300	301,5
400	402
500	502
600	601,5
700	702
800	802,5
900	902,5
1000	1002,5
2000	2003
3000	3003,5
4000	4005
5000	5006,5